

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2026 年 1 月 8 日**

**检查范围：化资学院教学科研实验室**

**检查人员：郭敏、刘正、李凯、校级实验室安全督察员**

化资学院：

1月8日，实验室管理处对化资学院教学科研实验室开展安全检查，检查发现，学院在实验室区域划分及使用、自制试剂管理、废弃物管理等方面，仍存在安全隐患。请学院进一步提高政治站位，压实安全管理主体责任，细化管控举措、狠抓工作落实。重点围绕规范人员操作流程、配齐配强个体防护装备等核心环节，加大专项检查频次与整改督查力度。对排查发现的隐患问题，能立整立改的，务必于放假前整改到位，坚决杜绝实验室“带病运行”；对暂无法立即整改的，要制定专项应急预案，采取切实有效的安全防范措施，全程跟踪管控，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

## 实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2026年1月8日	共性问题	1、实验室内未划分明确的实验区与学习区，个别房间学习区过于拥挤； 2、自配试剂标签不规范，未粘贴学校统一试剂标签； 3、废液桶未张贴醒目标识，缺少废液台账。
2026年1月8日	逸夫实验楼601	1、楼道内灭火器箱上堆放药品空瓶； 2、药品存储不规范，药品柜内固液试剂混放，未分类储存； 3、仪器设备放置于安全通道处，导致应急疏散通道狭窄。
2026年1月8日	逸夫实验楼603	1、易燃试剂乙醇存放位置距离烘箱过近。
2026年1月8日	逸夫实验楼504	1、逃生通道放置杂物，包括纸箱等易燃物。

2026年1月8日	逸夫实验楼506	1、药品柜台账信息更新不及时; 2、气瓶状态卡与实际情况不符; 3、试剂架堆放泡沫箱等易燃物，存在消防安全隐患。
2026年1月8日	逸夫实验楼427	1、有机实验操作未在通风橱下进行。
2026年1月8日	逸夫实验楼418	1、管制类易制爆化学品H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 存放不规范，且来源不明。
2026年1月8日	逸夫实验楼421	1、自制试剂标签不规范，未使用学校统一标签; 2、废液桶未张贴醒目标识，缺少废液台账。
2026年1月8日	逸夫实验楼419	1、插排未固定，且置于仪器设备上，存在消防安全隐患。
2026年1月8日	逸夫实验楼227	1、药品存储不规范，摆放随意，建议分类入柜存放。
2026年1月8日	逸夫实验楼221	1、净气型药品柜未保持通电状态，影响其正常功能。
2026年1月8日	逸夫实验楼111	1、存有极强腐蚀性化学品“氢氟酸”的药品柜无通风，且未发现六氟灵洗液等相应应急处置类药品; 2、娃哈哈饮用矿泉水瓶未按规定张贴“实验用水”标识标签。
2026年1月8日	逸夫实验楼106	1、娃哈哈饮用矿泉水瓶未按规定张贴“实验用水”标识标签
2026年1月8日	知化楼801	1、学生实验未穿实验服，实验室有饮食行为; 2、药品存储不规范，药品倒放; 3、管式炉尾端无有效的尾气排放处理设施，易导致气体中毒、窒息等问题。
2026年1月8日	知化楼809	1、实验室存在饮食行为。
2026年1月8日	知化楼806	1、实验室存放无标签的不明试剂。
2026年1月8日	知化楼701	1、药品存储不规范，药品倒放; 2、药品明细未及时更新; 3、长发实验人员未按规范盘起头发，易引发安全事故，且可能污染实验样品。
2026年1月8日	知化楼703	1、长发实验人员未按规范盘起头发，易引发安全事故，且可能污染实验样品。
2026年1月8日	知化楼501	1、长发实验人员未按规范盘起头发，易引发安全事故，且可能污染实验样品。 2、易燃药品甲醇与烘箱未保持安全距离。
2026年1月8日	知化楼505	1、真空干燥箱中放有纸箱、泡沫等可燃物; 2、实验室有饮食行为; 3、实验室卫生环境差。
2026年1月8日	知化楼514	1、实验室有饮食行为; 2、设备放置于安全通道处，导致应急疏散通道狭窄; 3、量筒破损仍在使用，存在安全隐患; 4、实验室卫生环境差。
2026年1月8日	知化楼410	1、插排未固定且串联使用; 2、发现疑似盐酸的管制类药品，未贴标签，且来源不明; 3、废液存放位置通风情况较差。
2026年1月8日	知化楼408	1、实验室杂物堆放，堵塞通道，阻碍应急疏散，易发生人员碰撞、摔倒等安全事故。

2026年1月8日	知化楼314	1、实验室内通道过窄，阻碍应急疏散，易发生人员碰撞、摔倒等安全事故。
-----------	--------	------------------------------------

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于1月14日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

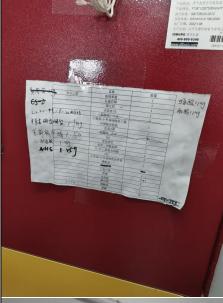
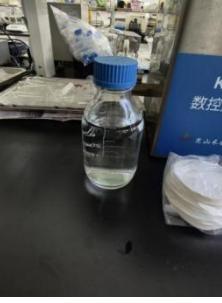
办公地点：综合办公楼 604

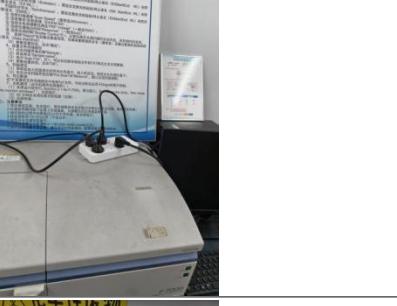
办公电话：82190708

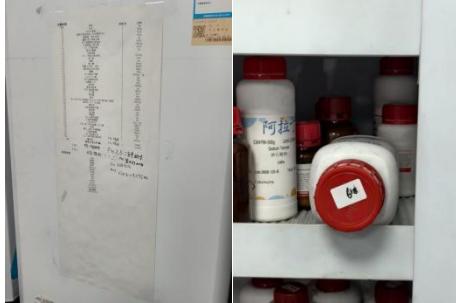
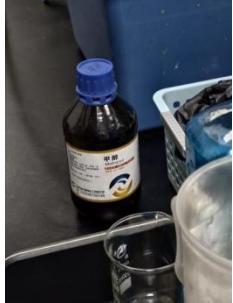
实验室管理与条件保障处

2026年1月8日

## 实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图			
逸夫实验楼601				
逸夫实验楼603				
逸夫实验楼504				
逸夫实验楼506				
逸夫实验楼427				

逸夫实验楼418			
逸夫实验楼421			
逸夫实验楼419			
逸夫实验楼227			
逸夫实验楼221			
知化楼801			

知化楼809	
知化楼806	
知化楼701	
知化楼501	
知化楼505	
知化楼514	

	 
知化楼410	 
知化楼408	
知化楼314	

