

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2026年4月2日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：郭敏、刘正、李凯、校级实验室安全督查员

化资学院：

4月2日，实验室管理处对化资学院教学科研实验室开展安全检查，检查发现，学院在实验室区域划分及使用、化学品管理、实验气体管理、用电安全、废弃物管理、实验室日常管理等方面，仍存在安全隐患。请学院进一步压实安全管理责任，细化管控举措，重点围绕规范人员操作流程、配齐配强个体防护装备等核心环节，加大专项检查与整改督查力度，对排查发现的隐患问题建立台账、限期整改、闭环销号，切实筑牢实验室安全防线，保障教学科研工作安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2026年4月2日	知化楼103	1、气瓶没有气瓶卡； 2、药品台账清单与药品柜实际存放药品不符，试剂管理混乱，存在严重安全管理隐患； 3、药品台账填写不规范，管制类药品存放超一周未合规管控，且未登记使用人员信息，流向无法追溯，属于严重违规管理隐患； 4、实验室内存在不同组分浓度的易燃气体，建议定期检查气体钢瓶密封性及保持良好的通风； 5、实验室存贮有氢氟酸试剂，未配备相应的应急防护用品（如六氟灵、葡萄糖酸钙软膏等），即日起严禁继续使用，须足额配齐专项应急药品物资，同步完善专项应急处置预案后方可启用。
2026年4月2日	知化楼105	1、真空干燥箱未张贴安全警示标识及标准操作规程； 2、废液存放区域未设置警戒隔离线及安全警示标识，分区不明确、无安全提示，存在废液混用、泄漏安全隐患；

		<p>3、实验台下柜门被设备阻挡，无法正常闭合，同时占用通行空间、阻碍人员走动，存在磕碰及应急通行受阻的安全隐患；</p> <p>4、实验室堆放大量纸箱，存在严重消防安全隐患；</p> <p>5、易制毒化学品使用后未及时归还，存在安全隐患；</p> <p>6、试剂柜中试剂存储不规范，存在强氧化性试剂与其他挥发性有机试剂混存的情况；</p> <p>7、试剂柜中存在高毒性危化品，建议寻找其替代品使用，使用时注意个体防护。</p>
2026年4月2日	知化楼035	1、普通冰箱存放易挥发易燃有机试剂，存在消防隐患。
2026年4月2日	知化楼037	<p>1、实验室违规使用非国标插排，易引发短路、发热起火，存在严重电气火灾安全隐患；</p> <p>2、加热设备未张贴安全警示标识及标准操作规程。</p>
2026年4月2日	知化楼034	<p>1、线路接线部位裸露无绝缘防护，易引发触电、短路，存在用电安全隐患；</p> <p>2、墙面插座防护盖板缺失，仅用透明胶带临时封堵，极易引发触电、杂物落入短路起火；</p> <p>3、墙面长期返潮渗水，墙体内部电线受潮老化，极易引发漏电、短路甚至起火，存在用电隐患。</p>
2026年4月2日	知化楼801	<p>1、实验室卫生环境差；</p> <p>2、实验人员未按规定穿着实验服；</p> <p>3、实验室未明确划分实验操作区与学习休息区，区域混用；且存在私放个人物品、在实验区域进食的违规行为，极易引发污染、中毒及消防安全风险。</p>
2026年4月2日	知化楼807	<p>1、电吹风等小型加热设备使用完毕未及时断电；</p> <p>2、药品台账清单与药品柜实际存放药品不符，试剂管理混乱，存在严重安全管理隐患；</p> <p>3、试剂柜中存在高毒性危化品，建议寻找其替代品使用，使用时注意个体防护；</p> <p>4、使用矿泉水瓶盛装化学试剂；且未张贴规范试剂标签，易引发误用、混配反应及中毒灼伤风险。</p>
2026年4月2日	知化楼809	<p>1、实验室未明确划分实验操作区与学习休息区，区域混用；且存在私放个人物品（打印机、充电器等物品）、在实验区域进食的违规行为，极易引发污染、中毒及消防安全风险；</p> <p>2、实验室卫生环境差；</p> <p>3、线路接线部位裸露无绝缘防护，易引发触电、短路，存在用电安全隐患；</p> <p>4、气瓶未固定。</p>
2026年4月2日	知化楼806	<p>1、实验室存在私放个人物品、在实验区域进食的违规行为，极易引发污染、中毒及消防安全风险。</p> <p>2、气体没有气瓶卡；</p> <p>3、多个加热设备共用同一插排，易引发线路过载、发热熔化、短路起火，火灾风险极高。应按额定功率匹配专用配电及插座，定期排查线路发热与老化隐患。</p>
2026年4月2日	知化楼307	1、药品台账填写极不规范，管制类危险药品领用、使用全程无记录。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于4月9日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2026年4月2日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
知化楼103	
知化楼105	
知化楼035	


知化楼037



知化楼034




知化楼807

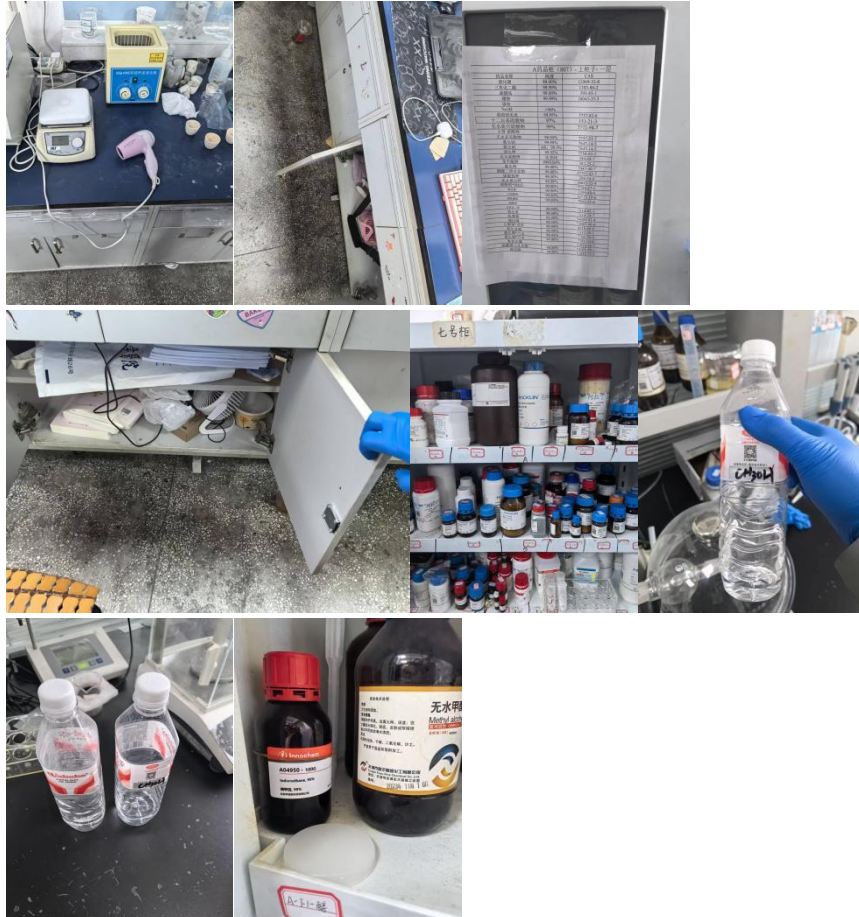

知化楼801



知化楼809

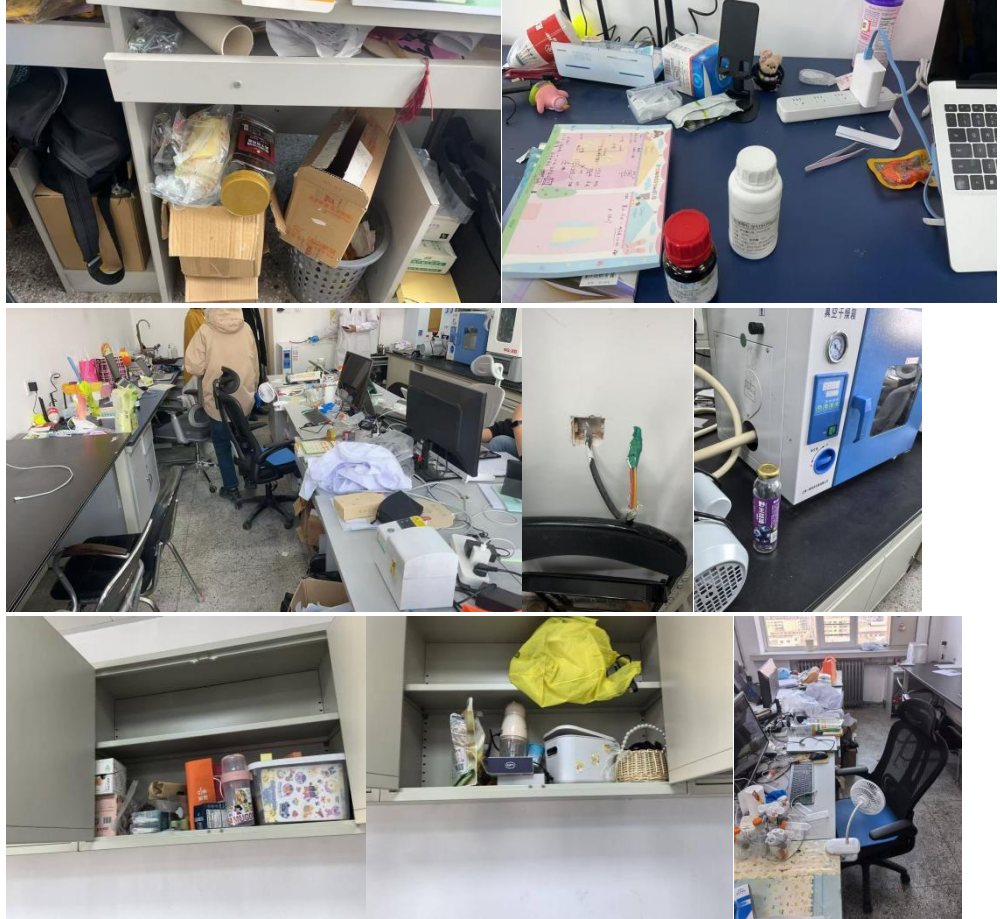

知化楼806



知化楼307

